

検査内容変更のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
このたび、下記検査項目について内容を変更しますのでご案内いたします。

記

■実施日 令和2年7月2日(木)ご依頼分より

■変更項目

総合検査案内ページ	検査項目	ページ	総合検査案内ページ	検査項目	ページ
34	17-KS7分画	p2	71	HIV-1 RNA定量	p3
35	プレグナンジオール	p2	98	遊離フェニトイン	p3
35	プレグナントリオール	p2	98	遊離バルプロ酸	p3
37	SCC	p2			

詳細については次頁以降をご参照ください。

- 17-KS7分画
- プレグナンジオール
- プレグナントリオール

提出容器個数を変更いたします。

総合検査案内ページ	項目コード	検査項目	変更内容	新	現
34	2036-05	17-KS7分画	容器	Y(2本)	Y
35	2085-05	プレグナンジオール			
	2086-05	プレグナントリオール			


● SCC

測定試薬の変更に伴い、検査方法を変更いたします。

総合検査案内ページ	項目コード	検査項目	変更内容	新	現
37	3040-02	SCC	検査方法	CLEIA	ECLIA

* 基準範囲の変更はありません。

▼現法と新法の比較

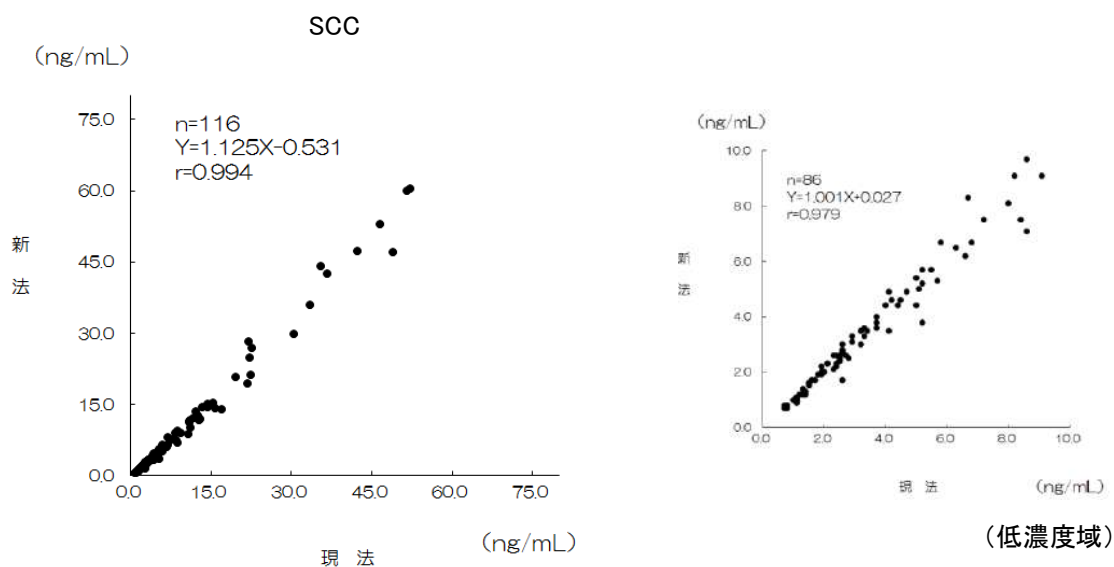

● HIV-1 RNA定量

項目コードを変更いたします。

総合検査案内ページ	項目コード	検査項目	変更内容	新	現
71	5985-03	HIV-1 RNA定量	項目コード	5985-39	5985-03

● 遊離フェニトイン

● 遊離バルプロ酸

最新のガイドラインに準じた基準範囲(治療濃度範囲)を設定いたします。

総合検査案内ページ	項目コード	検査項目	変更内容	新	現
98	0315-02	遊離フェニトイン	基準範囲 (治療濃度範囲) (単位)	1.0~2.0 ($\mu\text{g}/\text{mL}$)	設定なし
	0311-02	遊離バルプロ酸		5.0~15.0 ($\mu\text{g}/\text{mL}$)	設定なし