

## 肝炎ウイルス検診報告書のお知らせ(新規)

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別なご高配を賜り厚くお礼申し上げます。  
これまで、肝炎ウイルス検診の検査結果につきましては、フリーの『検査報告書』に印字してご報告しておりましたが、このたび、新たに専用報告書を作成しましたので、ご案内いたします。  
引き続き、先生方のご要望にお応えすべく研鑽を重ねてまいりますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。

敬白

記

■実施日 平成26年 10月 1日(水) ご報告分より

■変更内容

現

新

項目名	検査結果	基準値	単位
HBs抗原[CLIA]	0.05未満	0.05未満	IU/mL
HBs抗原判定	陰性	陰性	
HCV抗体の検出	2.57↑	1.00未満	S/CO
判定	陽性	陰性	
HCV抗体検査	1.2	1.0未満	COI
判定	陽性	陰性	
力値	低力価		
HCV RNA定量法	検出せず	参考基準値参照	Log IU/mL
HCV判定区分	③		

項目名	検査結果	基準値	単位
HBs抗原[CLIA]	0.05未満	0.05未満	IU/mL
HBs抗原判定	陰性	陰性	
HCV抗体の検出	2.57↑	1.00未満	S/CO
判定	陽性	陰性	
HCV抗体検査	1.2	1.0未満	COI
判定	陽性	陰性	
力値	低力価		
HCV RNA定量法	検出せず	参考基準値参照	Log IU/mL
HCV判定区分	③		

※肝炎ウイルス検診報告書には、検診の種類、検査の進み具合にもよりますが、最大で以下の4項目が印字されます。

- ・HBs抗原[CLIA]
- ・HCV抗体検査
- ・HCV抗体の検出
- ・HCV RNA定量[リアルタイムPCR]

※裏面をご参照願います。

# 肝炎ウイルス検診報告書 印字見本 (A5サイズ)

## 肝炎ウイルス検診 報告書

発行コード

ア-U-

1


437 999999-05 住所  
 氏名 テスト カン 様 施設名 テスト施設 様  
 備考 診療科  
 カルテ番号 病棟  
 受付番号 01-701019501 受付日 14年10月 1日 提出医  
 採取日 14年10月 1日 報告日 14年10月 2日

項目名	検査結果	コメント	基準値	単位	外
HBs抗原[CLIA]	0.05未満		0.05 未満	IU/mL	
HBs抗原判定	陰性		陰性		
HCV抗体の検出判定	2.57 ↑ 陽性		1.00未満 陰性	S/CO	
HCV抗体検査判定	1.2 ↑ A 陽性		1.0 未満 陰性	COI	1
力価	低力価				1
HCV RNA定量リアルタイムPCR	検出せず		参考基準値参照	Log IU/mL	1
HCV判定区分	③				

[コメント]  
 A:再検済みです。  
 [参考基準値]  
 『HCV RNA定量リアルタイムPCR』検査結果の表示パターン (4種)  
 「検出せず」…ウイルスは検出されませんでした  
 「1.2 未満」…極めて少ないウイルスが存在します  
 「1.2~7.8」…ウイルスが存在します (高ウイルス量は5.0以上)  
 「7.8 以上」…測定上限を超える量のウイルスが存在します

HCV判定区分の結果内容をフローチャートで確認できるようになりました。

C型肝炎ウイルス検査の指針のフローチャートを掲載しました。

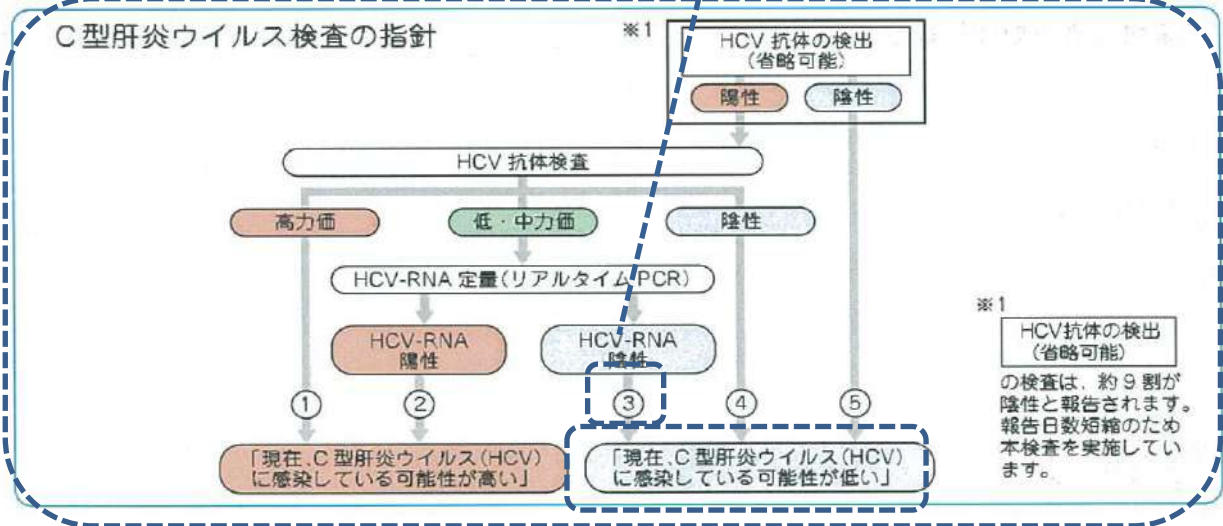

広島市医師会 検査責任者 亀石 猛  
 臨床検査センター

1. (株)エスアールエル 2. その他